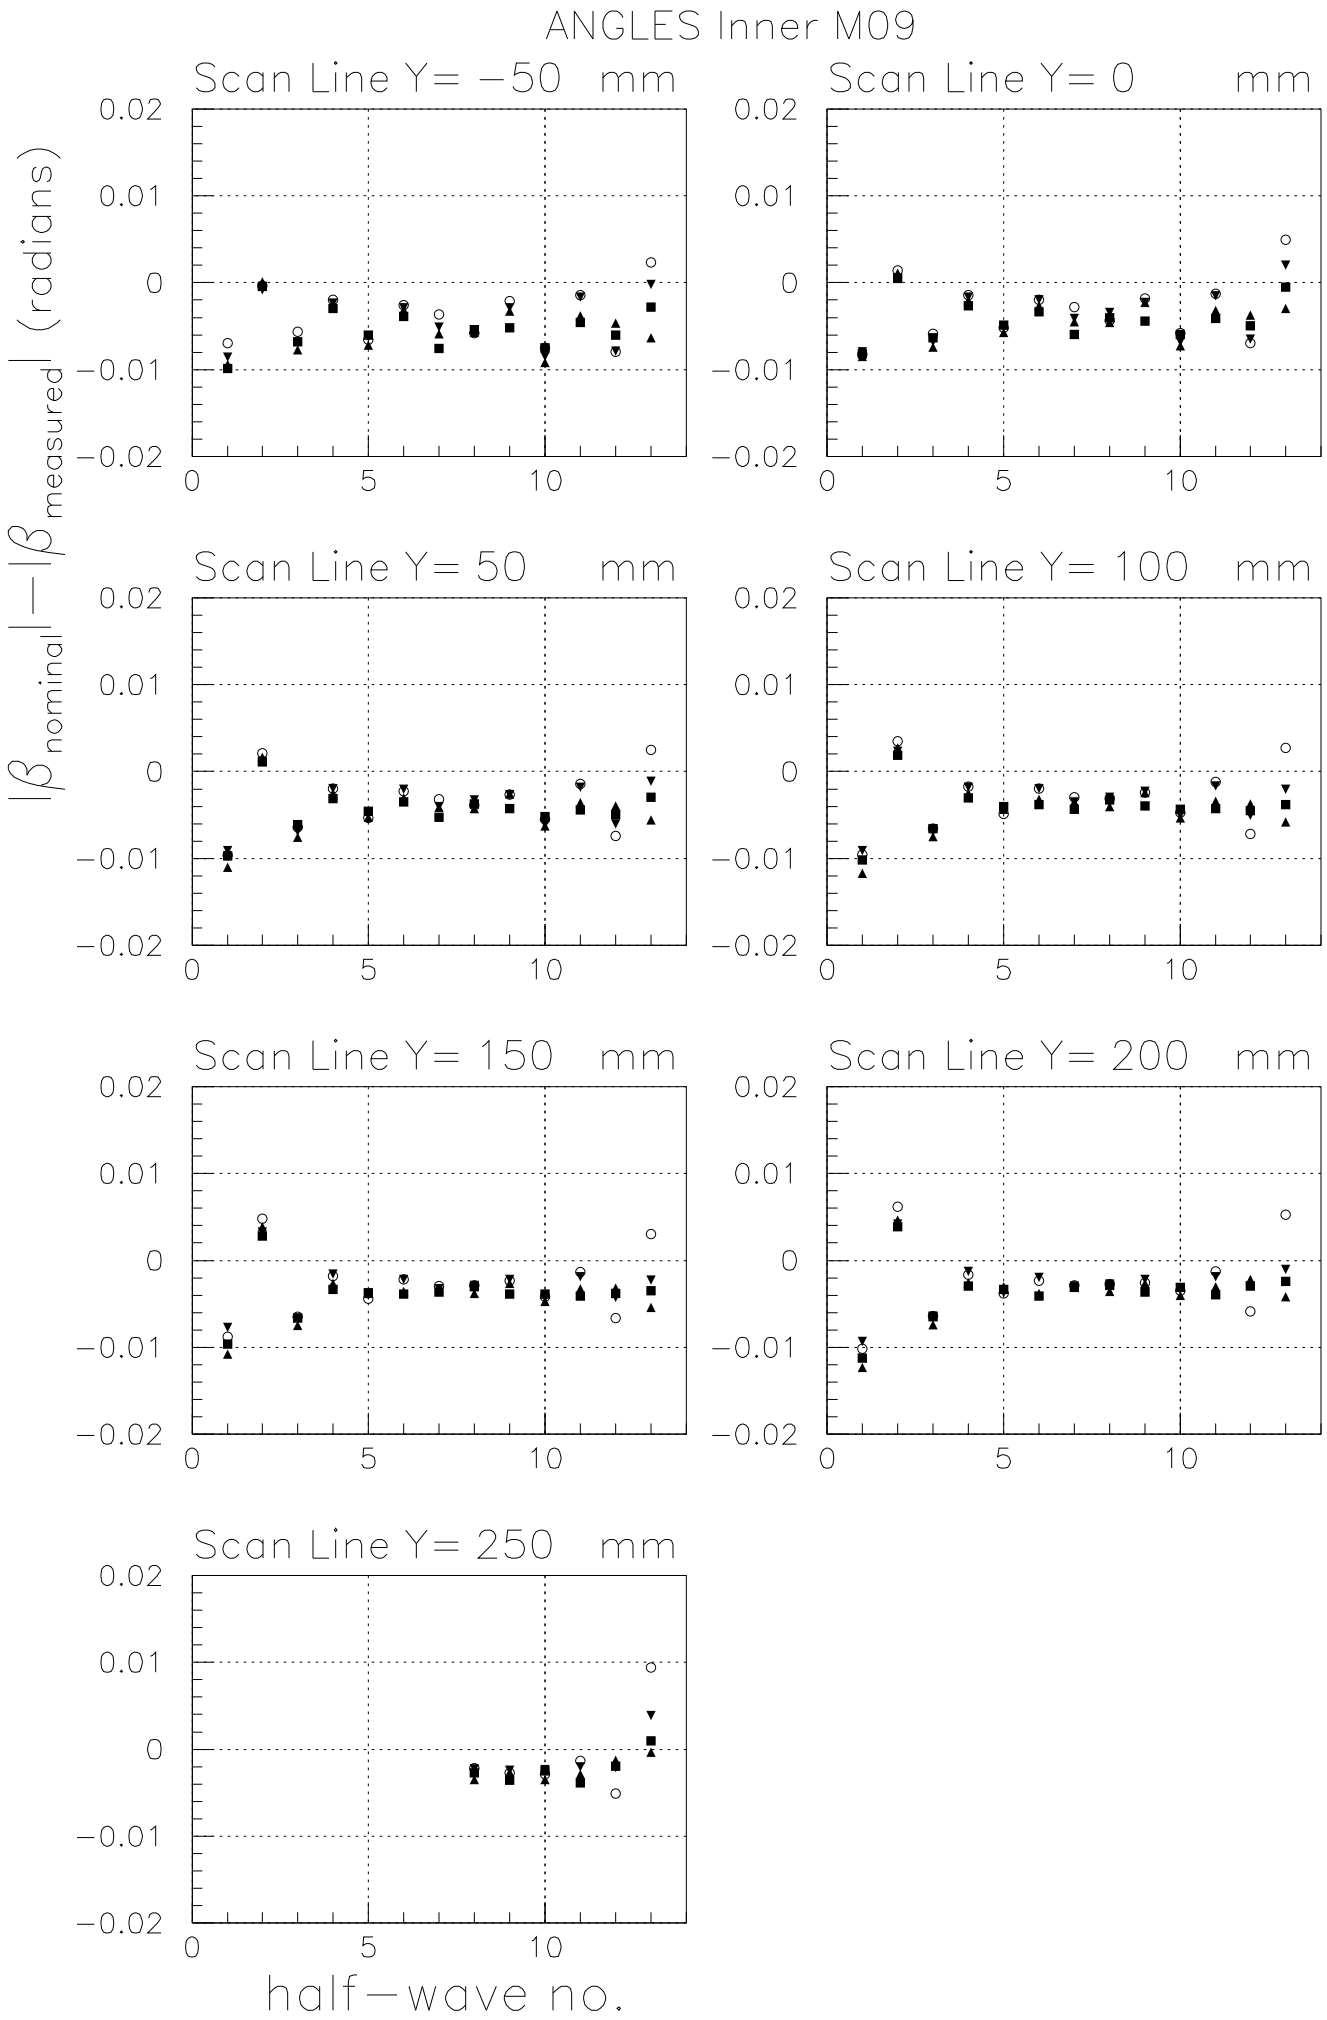
ANGLES Inner M09
Scan Line Y= −50 mm
Scan Line Y= 0 mm
Scan Line Y= 50 mm
Scan Line Y= 100 mm
Scan Line Y= 150 mm
Scan Line Y= 200 mm
Scan Line Y= 250 mm
|β_nominal| − |β_measured| (radians)
half−wave no.
0.02
0.01
0
−0.01
−0.02
0
5
10